


RELATÓRIO


Conforme análise do Termo de Referência do processo licitatório nº 55/2019 Pregão Presencial 23/2019, bem como dos questionamentos levantados pela empresa MF DE ALMEIDA E CIA LTDA, faz-se as seguintes observações, tocante aos itens nº 01 e nº 03 do edital:



Desta maneira, em consulta ao site oficial da marca cotada pela empresa, verifica-se que a pressão máxima é 116psi, diferente do solicitado no edital, que deveria ser de no mínimo 120psi.

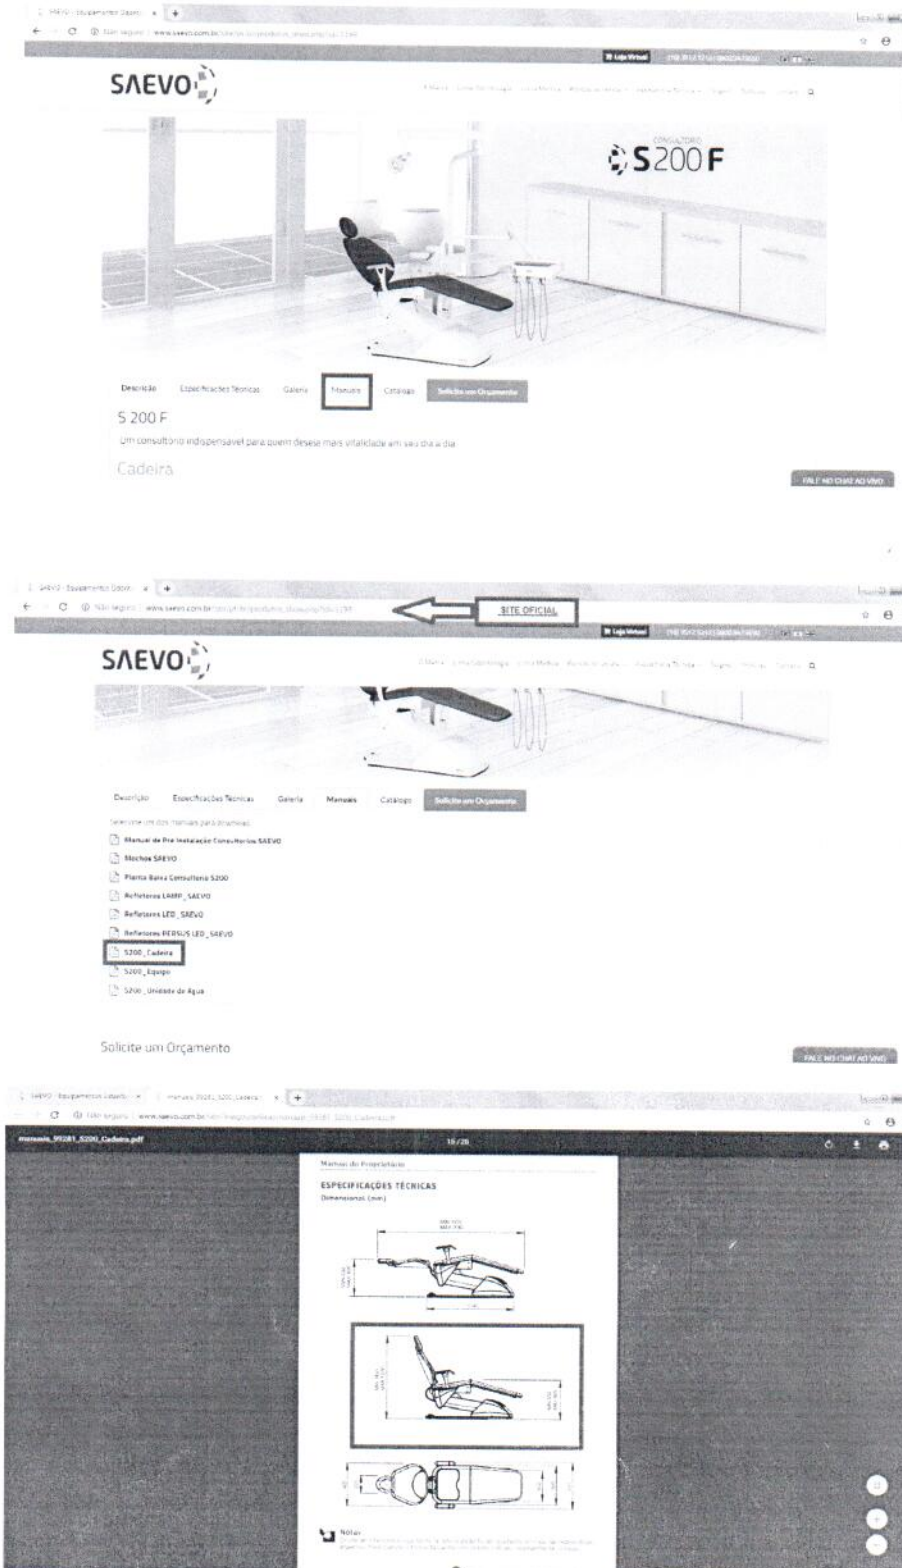

Porém, no manual de instrução do compressor é possível extrair a seguinte informação sobre o funcionamento do equipamento: “ O ar é comprimido dentro do reservatório de ar e um manômetro (maior) exhibe a pressão em seu interior. Quando a pressão do reservatório ultrapassar a marca de 0,8 MPa/8 bar/ 116 psi ou 8,16 kgf/cm, o desligamento do Compressor será automático. Quando a pressão atingir o limite inferior de 0,5 MPa/5 bar/ 72,5 psi ou 5,1 kgf/cm, o pressostato acionará o motor novamente até que seja alcançada o limite máximo, e assim sucessivamente (...) Verifique se a pressão exibida no manômetro do regulador de pressão (menor) está marcando 0,8 MPa / 8 bar / 120 psi ou 8,43 kgf/cm somente então abra o registro de saída de ar”.

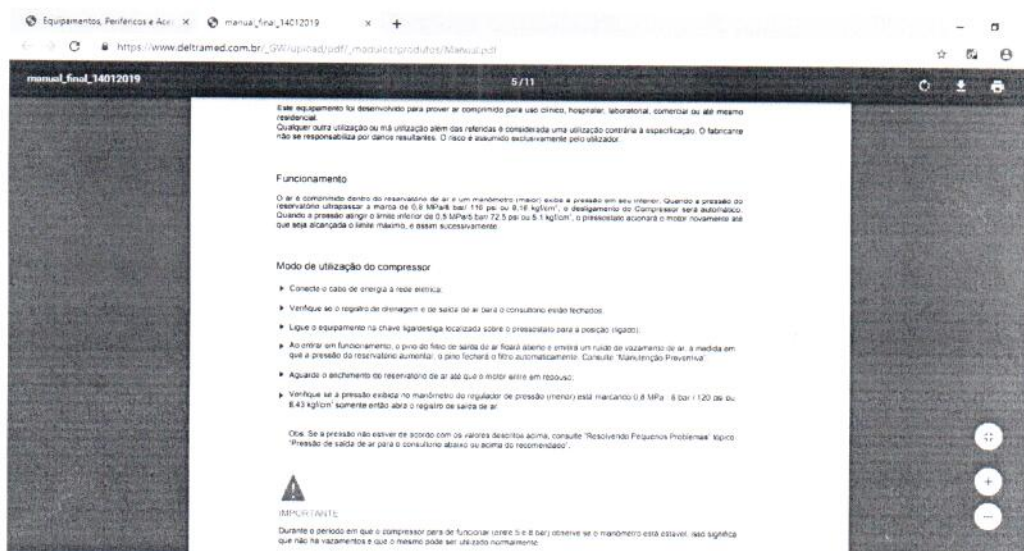

Assim, observa-se que o equipamento atinge a marca de 120psi, desligando-se automaticamente em 116psi a fim de garantir o melhor funcionamento do equipamento.

Observa-se que as informações constantes acima foram extraídas dos sites oficiais das marcas apresentadas pela empresa, na data de 21/05/2019 (<https://www.deltramed.com.br/Produtos.html> e <http://www.saevo.com.br/site/pt-br/>).


Drª Franciane Marta Simon
CRO/SC 13749

Cordilheira Alta, 21 de maio de 2019.

FRANCIANE MARTA SIMON
Odontóloga
Matrícula n. 1360802